


ANEXO 1. Método de dilución dinámica para calibrar analizadores de CO.

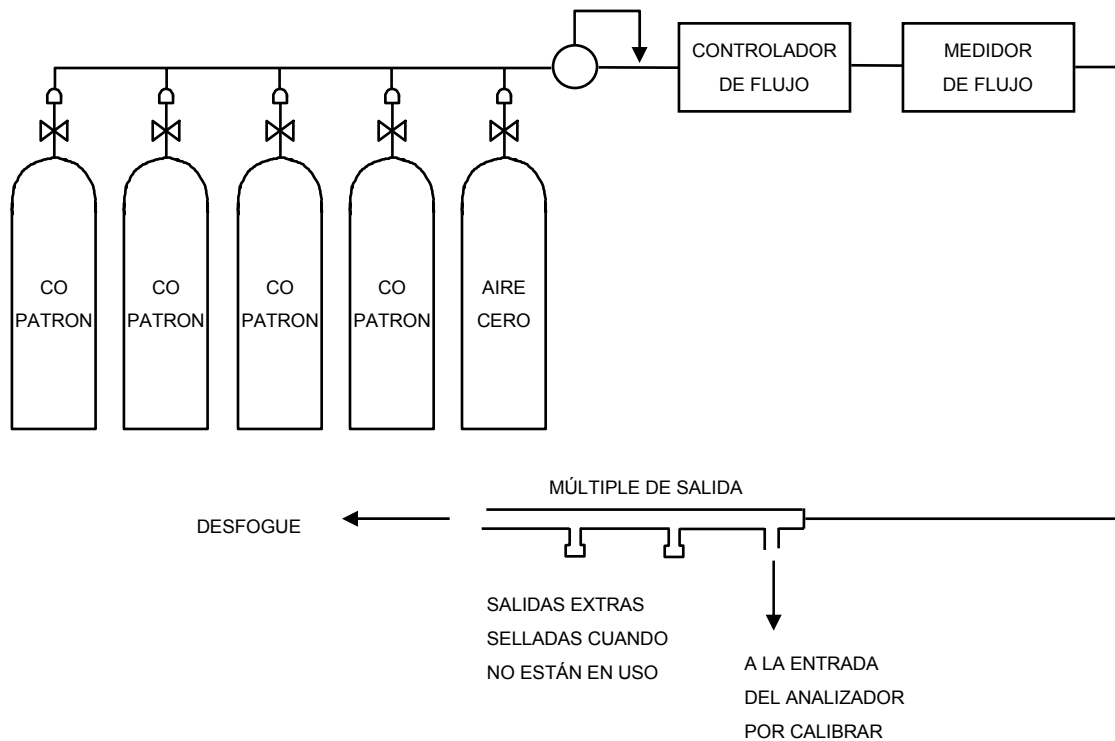

ANEXO 2. Método de cilindros múltiples para calibrar analizadores de CO.